



Ergänzende Informationen zur Auswahl der Audio- und Videoquellen in RED connect

Bitte beachten Sie:




Die Möglichkeit der Audio- und Videoquellenauswahl ist selbstverständlich sowohl in RED connect basis als auch in dem zukünftigen Upgrade-Paket RED connect plus dauerhaft enthalten.


Mehr dazu: [RED connect plus](#)

Erste Schritte

Für die Auswahl Ihrer Audio- und Videoquellen loggen Sie sich mit Ihren bisherigen Anmeldedaten auf <https://arzt.redmedical.de/> ein. Während der Videosprechstunde können Sie über die **Schaltfläche rechts oben** (hier im Bild: siehe Pfeil) jetzt auch Ihre Einstellungen bearbeiten.

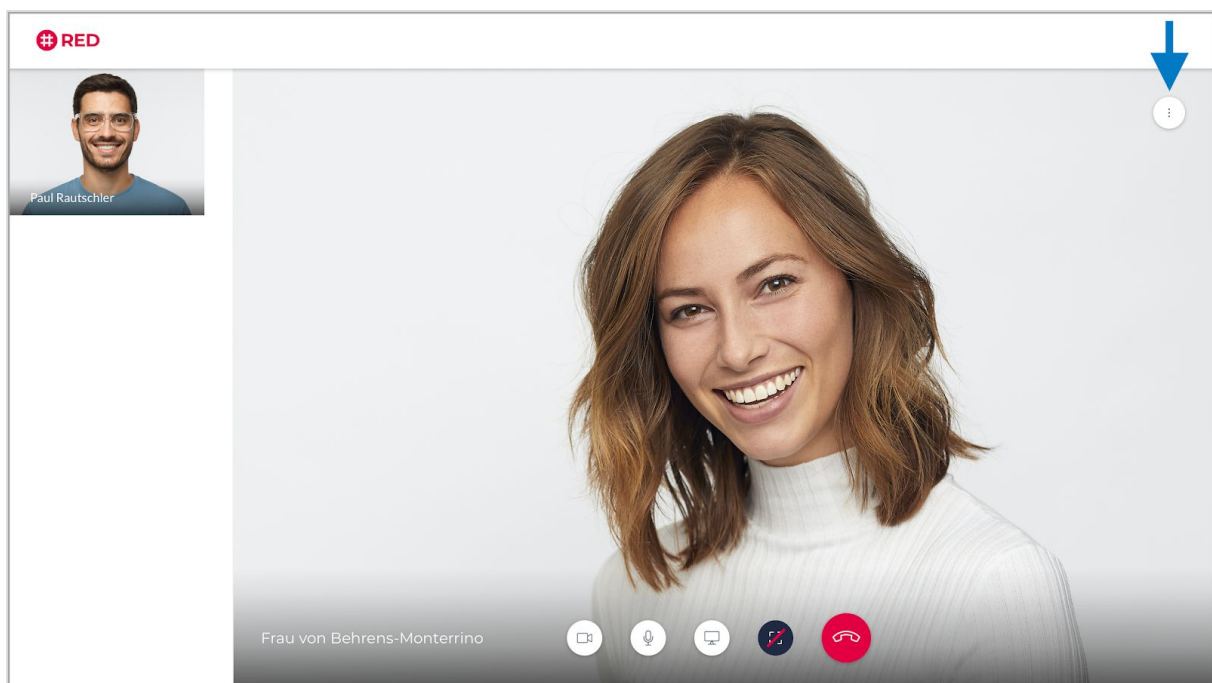

Audioquellen auswählen

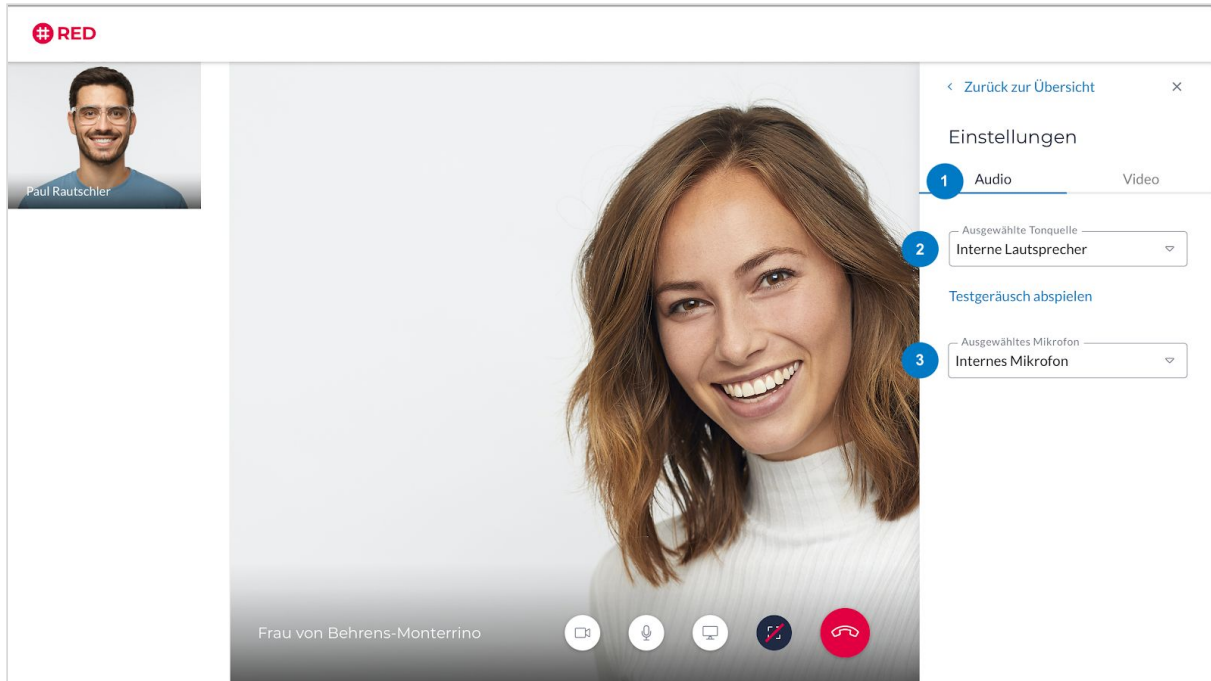

1 Nachdem Sie auf **“Einstellungen”** geklickt haben, konfigurieren Sie über das Bedienfeld **“Audio”** Ihren Lautsprecher sowie Mikrofon.

2 **Ausgewählte Tonquelle**


Über das Drop-Down-Menü können Sie die verfügbaren integrierten und externen Lautsprecher einsehen und per Klick auswählen.

Unser Tipp: Mit der darunterliegenden Funktion **“Testgeräusche abspielen”** können Sie die Tonqualität testen.

3 **Ausgewähltes Mikrofon**

Über das Drop-Down-Menü können Sie die verfügbaren integrierten und externen Mikrofone einsehen und per Klick auswählen.

Videoquellen auswählen

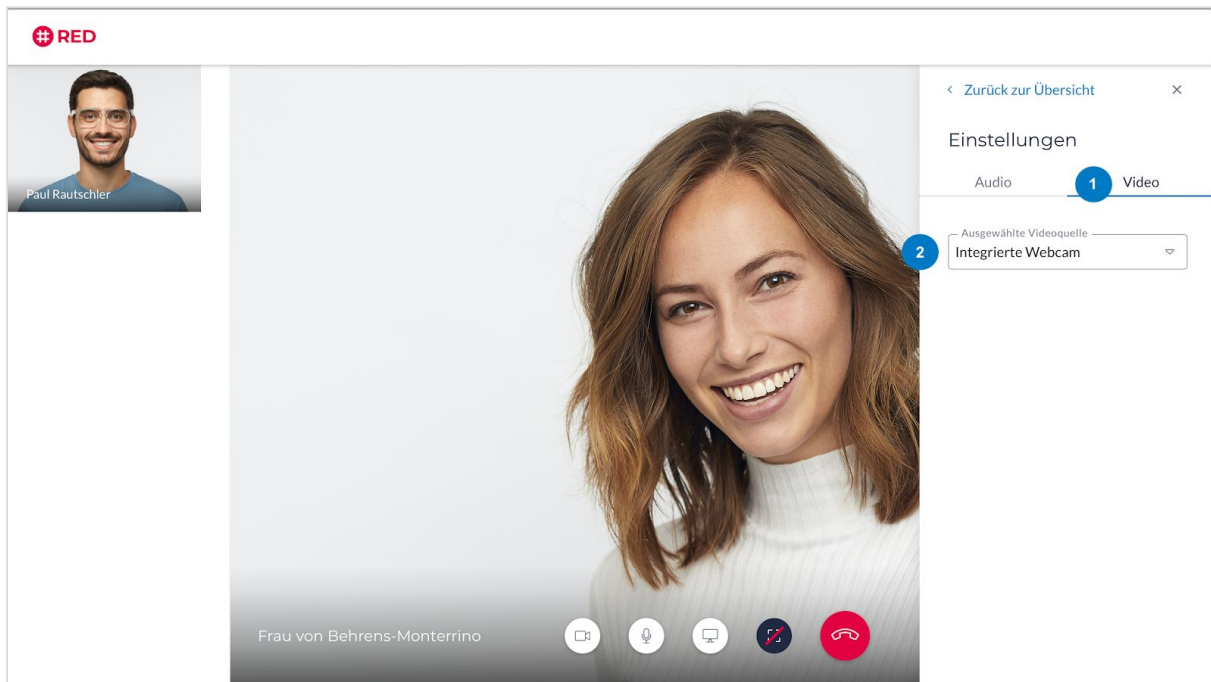

1 Über das Bedienfeld **“Video”** konfigurieren Sie Ihre Kameraquelle.

2 **Ausgewählte Videoquelle**

Über das Drop-Down-Menü können Sie die verfügbaren integrierten und externen Kameras einsehen und per Klick auswählen.

Über die Schaltfläche **“Zurück zur Übersicht”** gelangen Sie jederzeit wieder zur Auswahl zwischen der Teilnehmerübersicht und den Einstellungen. Mit Klick auf das **“X” rechts oben** schließen Sie das Menüfenster. Die Videosprechstunde läuft im Hintergrund kontinuierlich weiter.