

# Browser und Betriebssysteme

Wir bemühen uns durch eine sorgfältige Entwicklung und umfangreiche Tests, RED Medical für möglichst viele Betriebssysteme und Webbrowser verfügbar zu machen. Aus technischen Gründen schließen wir aber einige Betriebssysteme und Browser bzw. bestimmte ihrer Versionen aus.

Einige der ausgeschlossenen Betriebssysteme und Browser sind wenig verbreitet, und ihre Berücksichtigung würde für uns unverhältnismäßig große Aufwendungen für Entwicklung und Tests darstellen, was sich wiederum in unseren Preisen niederschlagen würde. Einige ältere Betriebssystem- und Browserversionen enthalten bestimmte von uns benötigte technische Funktionen noch nicht, oder werden von ihren Herstellern nicht mehr gepflegt, was sie zum Sicherheitsrisiko werden lässt.

Betriebssysteme und Browser werden von ihren Herstellern regelmäßig weiterentwickelt, um u.a. Sicherheitslücken zu beseitigen. Daher empfiehlt RED Medical dringend, immer die aktuellste Version von Browser und Betriebssystem zu verwenden.

Haben Sie Probleme den Browser upzudaten? Dann klicken Sie hier: [Browser ist nicht aktuell](#)

**RED Medical garantiert die volle Funktion nur für die nachfolgenden aufgeführten Betriebssysteme und Browser**

## Microsoft Windows

RED Medical kann mit allen [Windows-Versionen](#) betrieben werden, die von Microsoft zum aktuellen Zeitpunkt unterstützt werden. Ein Betrieb von RED Medical mit älteren Windows-Versionen ist technisch nur eingeschränkt möglich. Aus Sicherheitsgründen muss zudem dringend davon abgeraten werden, da Microsoft Fehler und Sicherheitslücken in diesen Betriebssystemen nicht mehr behebt.

RED Medical testet regelmäßig auf den aktuellen Windows Betriebssystemen mit den Webbrowsern [Mozilla Firefox](#), [Google Chrome](#) und [Edge Chromium](#).

**Windows 7** - wird von Microsoft seit 2015 nicht mehr weiter entwickelt. Der Support endet am **14.01.2020**. Ab diesem Zeitpunkt sollte Windows 7 auf Rechnern nicht mehr verwendet werden, die ans Internet angeschlossen sind. RED Medical kann auch nach diesem Zeitpunkt auf Rechnern mit Windows 7-Betriebssystem betrieben werden. Bei zukünftigen Entwicklungen werden wir aber keine Rücksicht mehr auf die technischen Gegebenheiten von Windows 7 nehmen. In der Zukunft kann es daher sein, dass RED auf Windows 7 Rechnern nicht mehr betrieben werden kann.

**Windows 8** - Support-Ende für Windows 8 ist der 10.01.2023. Ab diesem Zeitpunkt werden wir Windows 8 nicht mehr bei zukünftigen Entwicklungen berücksichtigen.

**Windows 10** - Informationen zum Support-Ende für Windows 10 finden Sie auf der [Microsoft Webseite zum Lebenszyklus von Windows](#).

Nicht mehr unterstützt werden **Windows XP und Windows Vista**, da der Support für diese Betriebssysteme durch Microsoft 2014 bzw. im April 2017 eingestellt wurde.

Außerdem unterstützt RED nicht mehr den **Internet Explorer 11 und Edge bis Version 44** welche von Microsoft funktional nicht weiter entwickelt werden und von RED benötigte technische Funktionen nicht mehr enthalten.

Bitte beachten Sie hierzu auch das [Schreiben der KV Nordrhein zur Nutzung von veralteten Browsern und Betriebssystemen](#)

## Apple macOS

RED Medical kann mit den jüngsten Versionen des Betriebssystems macOS betrieben werden. Da Apple den Webbrowser für ältere Versionen von macOS nicht mehr weiterentwickelt, eignen sich bestimmte ältere Versionen nicht mehr zum Betrieb mit RED Medical. RED Medical testet regelmäßig auf den aktuellen macOS Betriebssystemen mit den Webbrowsern [Safari](#), [Mozilla Firefox](#) und [Google Chrome](#).

## Apple iOS

RED Medical testet regelmäßig mit [Safari](#), dem Standardbrowser auf Apple Telefonen und Tablets. Sie finden Safari auf Ihrem Mobiltelefon oder Tablet als Icon.

## Android


RED Medical testet regelmäßig mit [Google Chrome](#), den Sie als zusätzlichen Browser auf Ihrem Android-Gerät verwenden können. Sie können [Chrome für mobile Geräte herunterladen](#) oder über den Google Play-Store beziehen.

Um RED connect nutzen zu können, wird stets ein aktueller Browser benötigt.

Im Regelfall wird die Aktualisierung des Browsers automatisch durchgeführt. Somit müssen Sie den Browser nur neu starten.

Bei **Edge Chromium** wird die Aktualisierung stets mit dem Windows-Update automatisch gemacht. Eigenständige Updates im Browser selbst, sind hier nicht verfügbar.

Falls eine automatische Aktualisierung bei Ihnen nicht stattfindet, befolgen Sie bitte folgende Schritte, in Abhängigkeit Ihres Betriebssystems und Browsers:

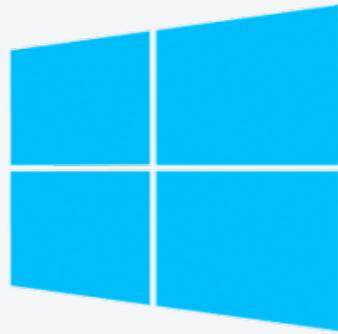

Windows®




### Firefox-Browser unter Windows manuell updaten

**Klicken Sie oben rechts im Bildschirm auf den Menü-Button und aktivieren Sie bitte den Menüpunkt "Hilfe".**

Sind U  
Diese:




In der

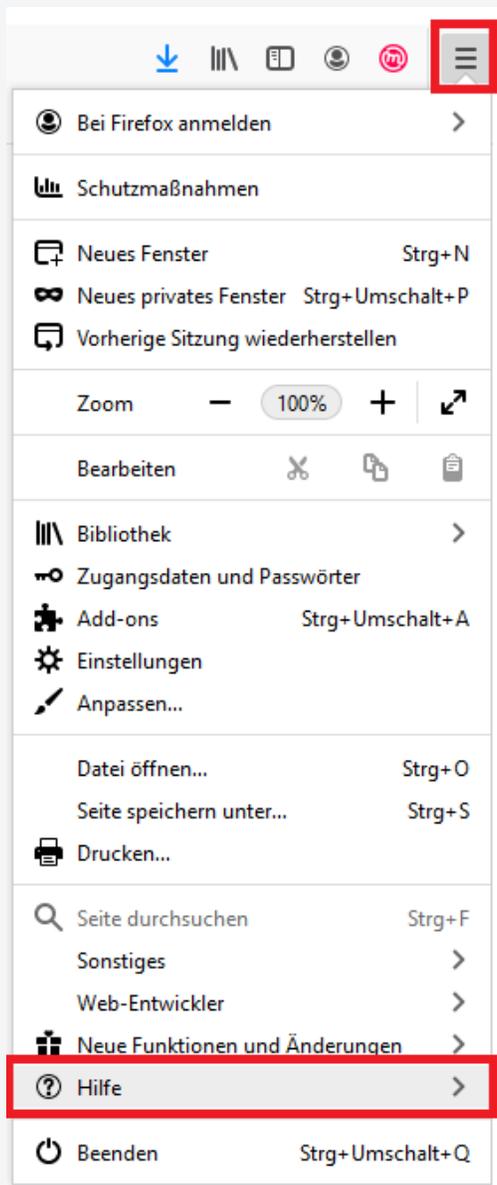

Dort v  
install

Über die Hilfe gelangen Sie zum Punkt "Über Firefox", welches Sie ebenfalls bitte aktivieren.

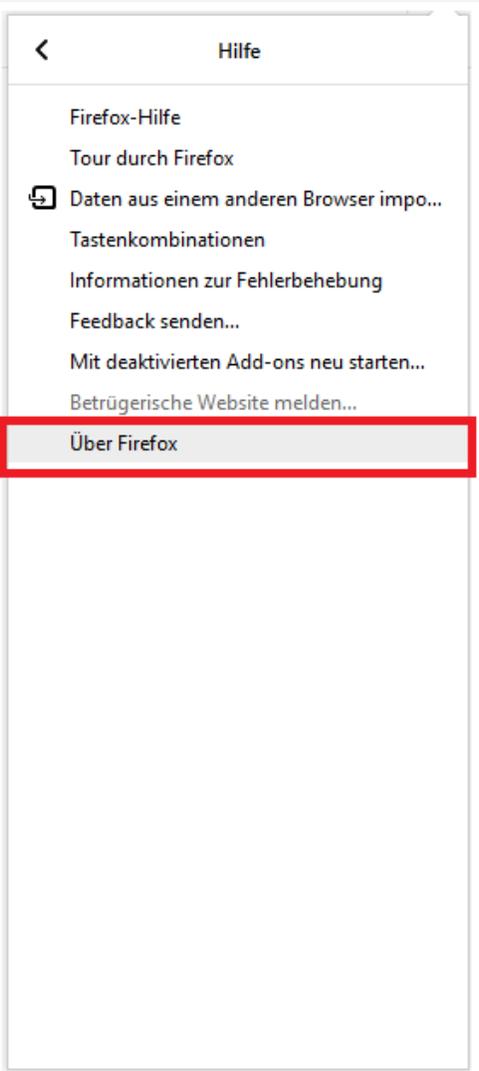

Klicke

Es öff  
klicke

Klicke  
Beim

Es öffnet sich ein neues Fenster, in dem automatisch nach einem Update gesucht wird. Ist eine neue Version verfügbar, klicken Sie auf den entsprechenden Button.




Klicken Sie anschließend auf den Button "Zum Abschließen des Updates Firefox neu starten", um das Update zu installieren. Beim nächsten Start von Firefox wird die aktuelle Version geladen.



## Google Chrome Browser unter Windows manuell updaten


Klicken Sie oben rechts im Bildschirm auf den Menü-Button. Dieser besteht aus drei untereinander angeordneten Punkten. Wählen Sie im Menü nun weiter unten den Punkt "Einstellungen" aus.

Klicke

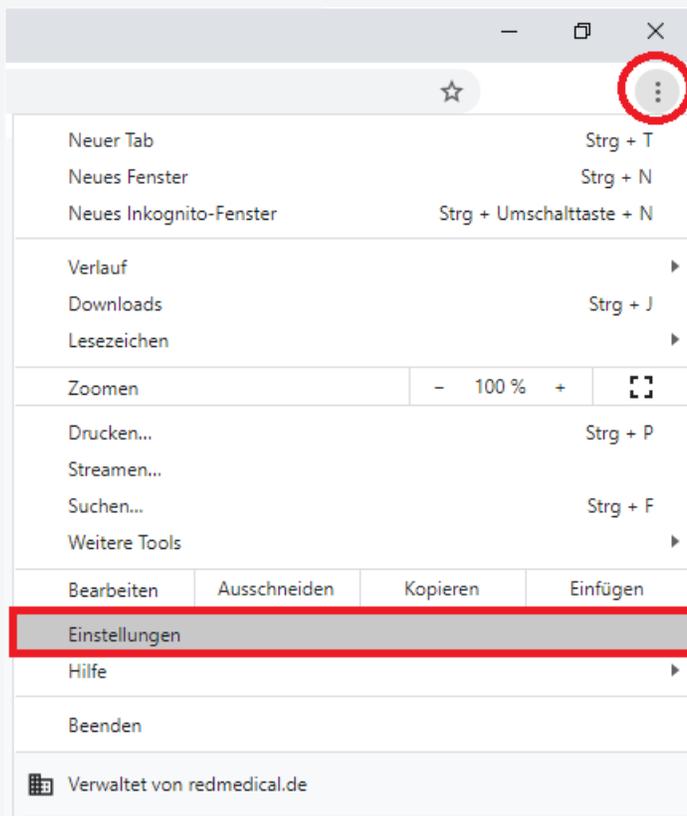

Hier w  
Beim

In den Einstellungen wird Ihnen links unten "Über Google Chrome" angezeigt. Dies wählen Sie bitte aus.

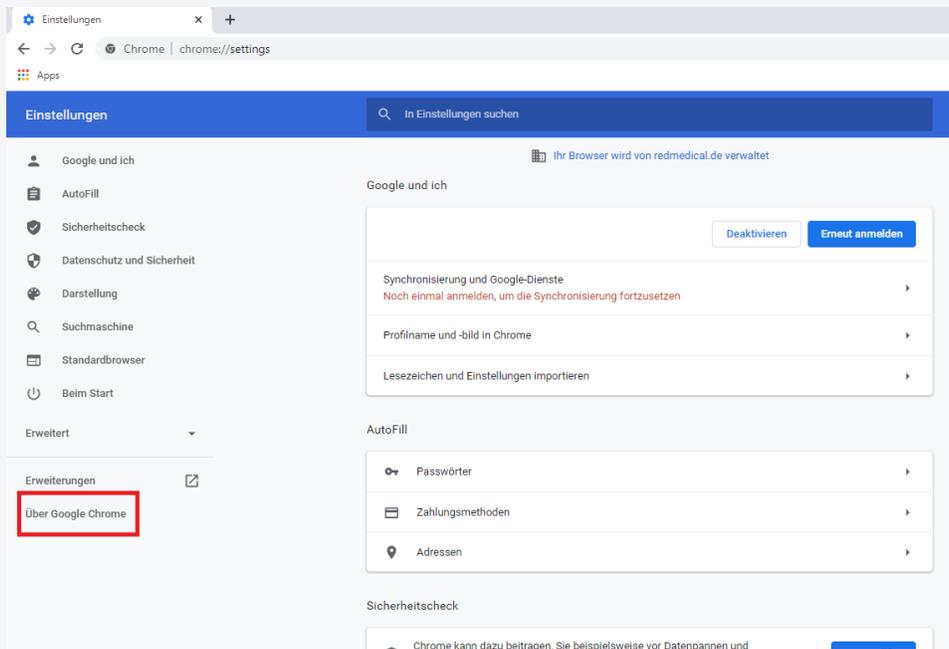

Hier wird automatisch nach Updates gesucht. Ist ein Update verfügbar, wird es automatisch heruntergeladen und installiert. Beim nächsten Start von Google Chrome wird die aktuelle Version geladen.

